日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

26. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

2003年 4月 2日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-099549

[ST. 10/C]:

[JP2003-099549]

出 願 人
Applicant(s):

株式会社湯山製作所

REC'D. 2 1 MAY 2004

WIPO


PCT

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月30日

今井康



【書類名】

特許願

【整理番号】

189040

【提出日】

平成15年 4月 2日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

B65B 61/02

B41J 3/407

B41J 15/04

B65B 9/10

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作

所内

【氏名】

湯山 正二

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作

所内

【氏名】

田中 徹

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号 株式会社湯山製作

所内

【氏名】

天津 俊宏

【特許出願人】

【識別番号】 592246705

【住所又は居所】 大阪府豊中市名神口3丁目3番1号

【氏名又は名称】 株式会社湯山製作所

【代理人】

【識別番号】

100084146

【弁理士】

【氏名又は名称】 山崎 宏

【選任した代理人】

【識別番号】

100100170

【弁理士】

【氏名又は名称】 前田 厚司

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 204815

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9814273

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 薬剤包装装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 包装紙に、印刷手段により印刷し、薬剤供給手段により薬剤を供給し、シール手段によりシールを施して1包分ずつ包装するようにした薬剤包装装置において、

前記シール手段は、包装紙を搬送する搬送部を備え、

前記印刷手段から前記シール手段に至る搬送経路の途中に、前記包装紙が接触 して張力が一定値に維持されるように移動する移動手段と、

該移動手段の移動位置を検出する位置検出手段とを設け、

該位置検出手段により前記移動手段による移動位置が所定位置となることにより、前記印刷手段による印刷を開始させるようにしたことを特徴とする薬剤包装 装置。

【請求項2】 前記移動手段は、回転及び移動自在なローラと、該ローラを 移動させて前記包装紙に一定力で付勢させる付勢手段とで構成したことを特徴と する請求項1に記載の薬剤包装装置。

【請求項3】 包装紙に、印刷手段により印刷し、薬剤供給手段により薬剤を供給し、シール手段によりシールを施して1包分ずつ包装するようにした薬剤包装装置において、

前記シール手段は、包装紙を搬送する搬送部を備え、

前記印刷手段から前記シール手段に至る搬送経路の途中に、前記包装紙に作用する張力を検出する張力検出手段を配設し、

該張力検出手段での検出張力が予め設定した所定値となった後、前記搬送部による包装紙の搬送位置に基づいて、前記印刷手段による印刷を開始させるように したことを特徴とする薬剤包装装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、薬剤包装装置に関するものである。



【従来の技術】

従来、薬剤包装装置として、プリンタヘッド間に包装紙との接触により回転する検出ローラを設け、この検出ローラの回転量に基づいてエンコーダにより包装紙の送り量を検出し、その検出結果に基づいてプリンタヘッドを作動させるようにしたものがある(例えば、特許文献1参照)。

[0003]

【特許文献1】

特許第2579010号公報

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、前記薬剤包装装置では、包装紙の送り量を検出するようにしているだけである。このため、印刷開始時、プリンタヘッドと、その下流側のヒートシール部との間の包装紙に弛みがあると、印刷位置とヒートシール位置との間の寸法を所定値とすることができず、所望位置に印刷できないという問題がある

[0005]

そこで、本発明は、包装紙の所望位置に正確に印刷することのできる薬剤包装 装置を提供することを課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記課題を解決するための手段として、包装紙に、印刷手段により 印刷し、薬剤供給手段により薬剤を供給し、シール手段によりシールを施して1 包分ずつ包装するようにした薬剤包装装置において、

前記シール手段は、包装紙を搬送する搬送部を備え、

前記印刷手段から前記シール手段に至る搬送経路の途中に、前記包装紙が接触 して張力が一定値に維持されるように移動する移動手段と、

該移動手段の移動位置を検出する位置検出手段とを設け、

該位置検出手段により前記移動手段による移動位置が所定位置となることによ

り、前記印刷手段による印刷を開始させるようにしたものである。

[0007]

この構成により、移動手段の移動位置すなわち包装紙との接触位置と、印刷手段による印刷位置との間の寸法を所定値とすることができ、印刷位置に対するシール位置の位置ずれを防止することが可能となる。

[0008]

前記移動手段は、回転及び移動自在なローラと、該ローラを移動させて前記包 装紙に一定力で付勢させる付勢手段とで構成すればよい。

[0009]

また、本発明は、前記課題を解決するための手段として、包装紙に、印刷手段により印刷し、薬剤供給手段により薬剤を供給し、シール手段によりシールを施して1包分ずつ包装するようにした薬剤包装装置において、

前記シール手段は、包装紙を搬送する搬送部を備え、

前記印刷手段から前記シール手段に至る搬送経路の途中に、前記包装紙に作用する張力を検出する張力検出手段を配設し、

該張力検出手段での検出張力が予め設定した所定値となった後、前記搬送部による包装紙の搬送位置に基づいて、前記印刷手段による印刷を開始させるようにしたものである。

[0010]

この構成により、包装紙に弛みのない一定張力が作用した状態で、印刷手段による印刷を開始させることができ、印刷位置に対して常に一定位置でシールを行うことが可能となる。


[0011]

【発明の実施の形態】

以下、本発明に係る実施形態を添付図面に従って説明する。

[0012]

図1は、本実施形態に係る薬剤包装装置を示す。この薬剤包装装置は、装置本体1の上方側に、本発明に係る薬剤供給手段である錠剤供給部2、及び、散薬供給部3を備え、下方側に、印刷ユニット5 (印刷手段)、及び、包装ユニット8



[0013]

錠剤供給部2は、格子状に形成された各ボックス内に、予め、1包分の錠剤を 手撒きにより収容し、順次、各ボックスの底板を開放することにより、包装ユニット8で包装できるようにしたものである。

[0014]

散薬供給部3は、ホッパー4を介して供給した散薬を、図示しない分配皿の外 周環状溝に供給し、散薬掻出装置(図示せず)により1包分ずつ掻き出し、順次 、包装ユニット8で包装できるようにしたものである。

[0015]

印刷ユニット 5 は、図 2 乃至図 4 に示すように、ロール 6 に巻回した包装紙 7 を巻き戻し、印刷を施した後、包装ユニット 8 へと搬送するようにしたものである。包装紙 7 は、ガイド部 9 によって水平方向に方向変換され、その上面側で熱転写部(プリンタヘッド) 1 0 によってインクリボン 1 1 のインクを熱転写される。印刷された包装紙 7 は、テンションローラ 1 2 を通過し、第 1 ローラ 1 3 で上方に方向変換され、ガイド片 1 4 によってガイドされて上昇し、第 2 ローラ 1 5 で斜め下方に方向変換されて包装ユニット 8 へと向かう。

[0016]

前記インクリボン11は、図3及び図4に示すように、第1ロール16に巻回されており、順次、巻き戻されて第2ロール17に巻回される。各ロール6は筒状で、周囲4箇所のガイド軸18の両端部に固定した保持プレート19に内筒6aを保持され、インクカートリッジ20を構成する。下方側ガイド軸18から延びるアーム部21の先端には補助ローラ22が回転自在に取り付けられている。

[0017]

前記インクカートリッジ20は、各ロール16,17の内筒16a,17aに 側板23から突出する軸部24a,24bがそれぞれ挿通し、軸部24a,24 bの先端にナット等を螺合することにより、側板23に取り付けられる。そして 、軸部24bを図示しないモータ(インクリボン搬送部)を駆動して回転するこ とにより、第1ロール16に巻回したインクリボン11を第2ロール17に巻き 取ることが可能である。このとき、インクリボン11は、熱転写部10とガイド部9との間に位置決めし、付勢ローラ25によって弛みを除去する。付勢ローラ25は、支軸26aを中心として回動自在に設けたアーム部材26の先端に回転自在に設けられている。アーム部材26は、一端部を装置本体1側に取り付けた取付片43に係止したスプリング27によって支軸26aを中心として、図4中、時計回り方向に付勢されている。

[0018]

前記テンションローラ12(本発明の移動手段)は、図5及び図6に示すように、昇降台28から延設される支持部29に回転自在に取り付けられている。昇降台28には、テンションローラ12の上方側に包装紙7が挿通する通路を構成するためのカバー30を設けられている。そして、昇降台28は、所定間隔で立設したガイドレール31に沿って昇降自在に設けられ、スプリング32によって上方に付勢されている。昇降台28は、内蔵したマグネット44を、側方に配置したセンサ33(本発明の位置検出手段)で検出されることにより、降下位置を特定される。また、昇降台28は、包装紙7を挿通しやすいように、係止凹部28aに側板23に設けた板バネからなる係止片45を係止することにより、最下位置に位置決めされる。

[0019]

包装ユニット8は、前記印刷ユニット5で印刷した包装紙7を、2つ折り、あるいは、予め2つ折りにした状態で、本発明に係るシール手段であるシール部34にて、長手方向に所定間隔でシールし、形成された袋部に、前記錠剤供給部2又は前記散薬供給部3から供給される薬剤を回収ホッパー35を介して回収し、残る1辺をシールするようにしたものである。

$[0\ 0\ 2\ 0]$

前記シール部34は、斜め下方に向かう包装紙7に対応して傾斜した状態で取り付けられている。シール部34では、図7に示すように、装置本体1の側板23の背面側に設けたモータ37により直動ギア38a及び間欠ギア38bを介して一対の送りローラ39が間欠的に回転駆動する。これにより、送りローラ39間に挟持された包装紙7が間欠的に搬送される。また、前記モータ37により、

ギア40a, 40b等を介してヒータローラ41, 42が回転し、搬送される包装紙7をシールする。ヒータローラ41, 42には両端外周面と、これらを結ぶ長手方向の2箇所にヒートシール部41a, 42aが形成されている。これにより、ヒータローラ41, 42が回転すると、包装紙7が長手方向に所定間隔でシールされると共に、側縁部がシールされる。ここでは、モータ37には、ステッピングモータを使用し、印加電圧のパルスを変更することにより搬送量を調整している。

[0021]

次に、前記薬剤包装装置の動作を説明する。

[0022]


包装処理を開始する前の状態であれば、包装ユニット8のヒータローラ41,42と、印刷ユニット5の熱転写部10との間で、包装紙7に弛みが発生していることがある。この弛みは、図8の2点鎖線で示すように、付勢されたテンションローラ12が上方に移動することによって吸収される。この場合、シール部34と熱転写部10との距離が、吸収された弛み量によって変化する。

[0023]

そこで、まず、送りローラ39を回転駆動し、包装紙7を搬送する。これにより、包装紙7に作用する張力が増大し、これに伴ってテンションローラ12がスプリング32による付勢力に抗して降下する。そして、センサ33によりテンションローラ12が降下位置まで降下したことが検出されれば、熱転写部10を加熱して包装紙7への印刷を開始する。つまり、包装紙7に作用する張力を一定値として包装紙7への印刷を行うことができ、シール部34と熱転写部10との間に位置する包装紙7の寸法を常に同一とすることが可能となる。

[0024]

続いて、所定の印刷を施された包装紙7が包装ユニット8へと搬送されれば、 ヒータローラ41,42が回転することにより、2つ折り状態で搬送されて来た 包装紙7をシールして袋状とする。そして、処方箋データに従って錠剤供給部2 又は散薬供給部3から薬剤を供給し、回収ホッパー35を介して包装紙7へと収 容する。その後、前記ヒータローラ41,42の回転を続行することにより、包



[0025]

このように、前記薬剤包装装置によれば、包装処理を開始する際、必ず、テンションローラ12を降下させてセンサ33にて検出してから印刷を開始するようにしている。したがって、包装紙7に作用する張力を一定値とし、シール部34と熱転写部10との寸法を正確に一定寸法に維持することができ、所望の位置に確実に印刷することが可能となる。

[0026]

なお、前記実施形態では、テンションローラ12を昇降可能な構成し、その位置を検出することにより、包装紙7の印刷位置とシール位置とを一定寸法に維持するように構成したが、例えば、包装紙7に作用する張力を検出する張力検出手段を設け、この張力検出手段で検出される張力が所定値となってから、熱転写部10による印刷を開始するようにしてもよい。張力検出手段としては、包装紙7に当接し、その張力の違いにより回動角度を変更するアーム等が挙げられるが、その構成については何等限定されるものではない。

[0027]

【発明の効果】

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、検出張力が予め設定した所 定値となった後、搬送部による包装紙の搬送位置に基づいて、印刷手段による印 刷を開始させるようにしたので、搬送位置と印刷位置との位置関係を常に一定寸 法に維持することができ、所望位置に正確に印刷を行うことが可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】 本実施形態に係る薬剤包装装置の斜視図である。
- 【図2】 図1の印刷ユニット及び包装ユニットを示す斜視図である。
- 【図3】 図1の印刷ユニット及び包装ユニットの正面図である。
- 【図4】 図3の部分拡大正面図である。
- 【図5】 図4の側面図である。
- 【図6】 図5のテンションローラ近傍の拡大図である。
- 【図7】 (a) は図1の包装ユニットの平面図、(b) はその正面図であ


る。

【図8】 包装紙の搬送経路を示す概略説明図である。


【符号の説明】

- 1…装置本体
- 2…錠剤供給部
- 3…散薬供給部
- 4…ホッパー
- 5…印刷ユニット
- 6…ロール
- 7…包装紙
- 8…包装ユニット
- 9…ガイド部
- 10…熱転写部
- 11…インクリボン
- 12…テンションローラ
- 13…第1ローラ
- 14…ガイド片
- 15…第2ローラ
- 16…第1ロール
- 17…第2ロール
- 16a, 17a…内筒
- 18…ガイド軸
- 19…保持プレート
- 20…インクカートリッジ
- 21…アーム部
- 22…補助ローラ
- 23…側板
- 24a, 24b…軸部
- 25…付勢ローラ


- 26…アーム部材
- 2 6 a …支軸
- 27…スプリング
- 28…昇降台
- 28 a …係止凹部
- 2 9 … 支持部
- 30…カバー
- 31…ガイドレール
- 32…スプリング
- 33…センサ
- 3 4 …シール部
- 35…回収ホッパー
- 3 6 …取付板
- 37…モータ
- 38 a…直動ギア
- 38b…間欠ギア
- 39…送りローラ
- 40a, 40b…ギア
- 41, 42…ヒータローラ
- 41a, 42a…ヒートシール部
- 4 3 …取付片
- 44…マグネット
- 4 5 … 係止片



【図1】

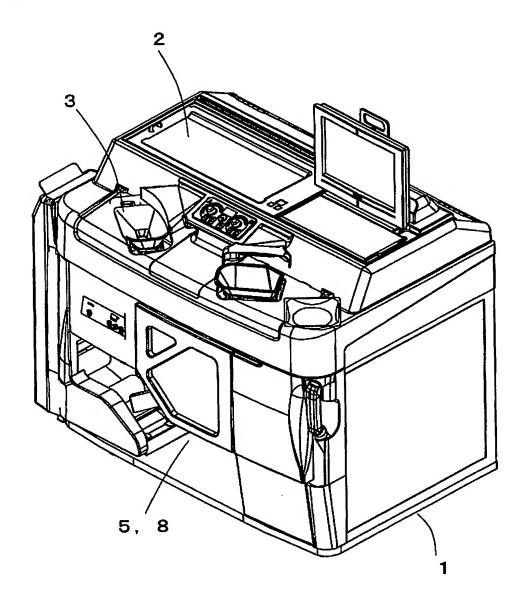




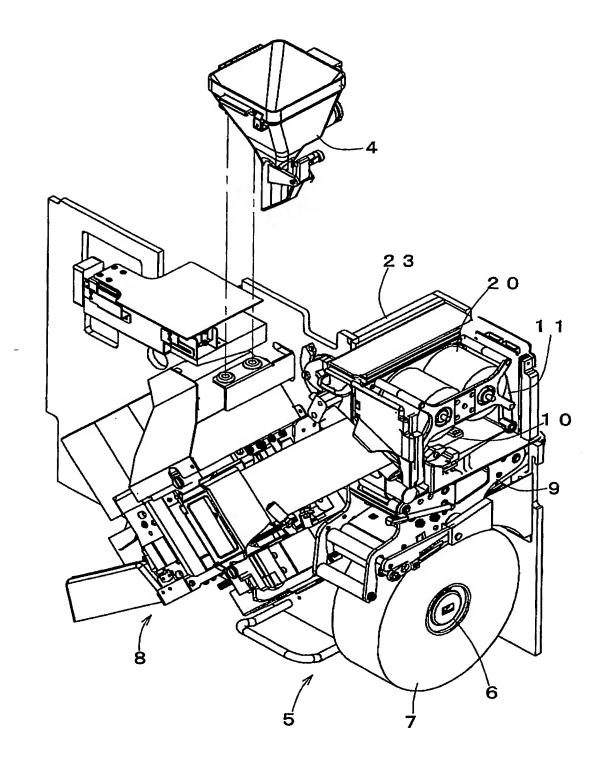





【図3】

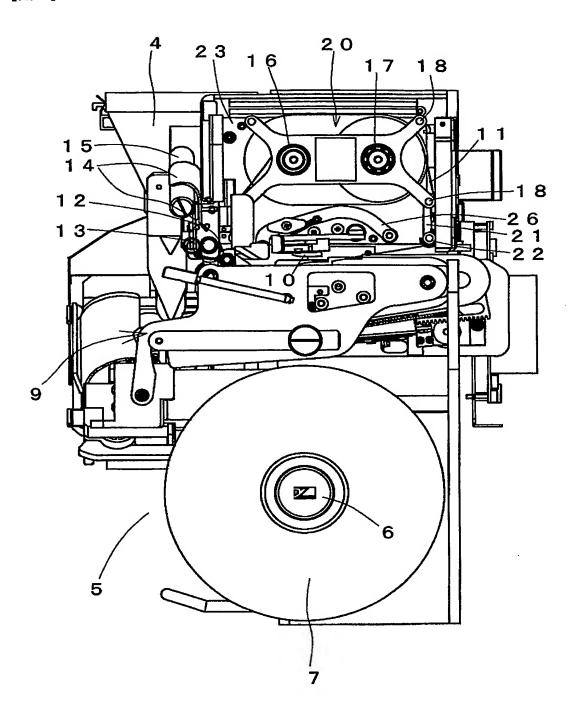


【図4】

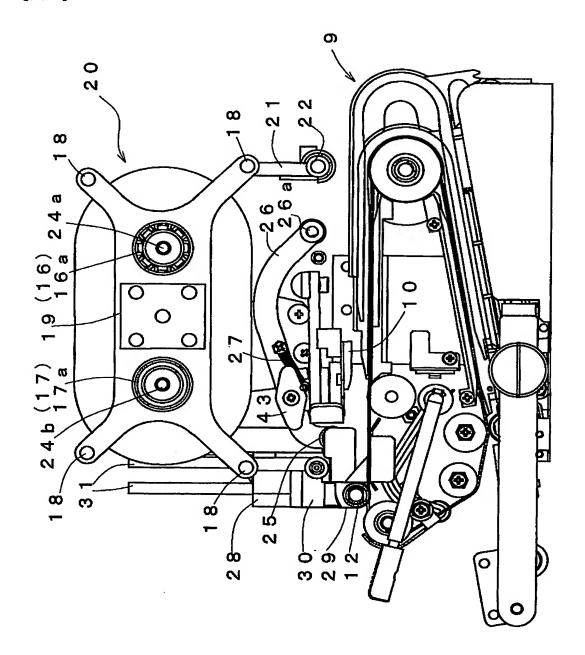




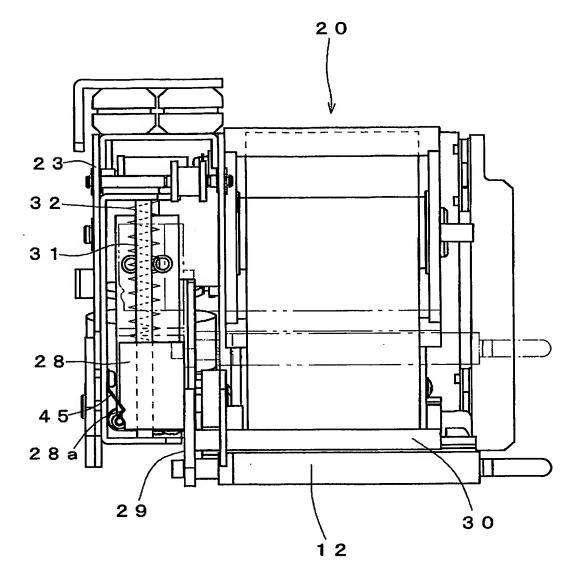




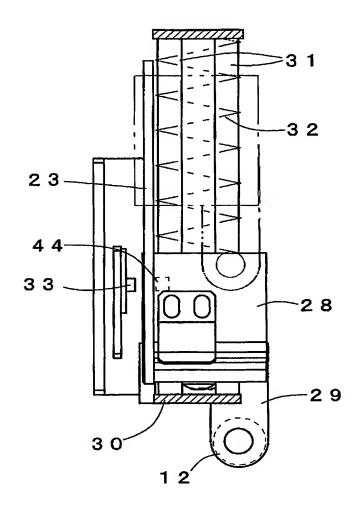


【図7】

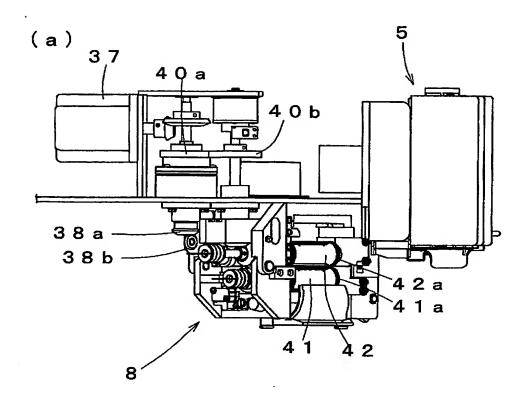

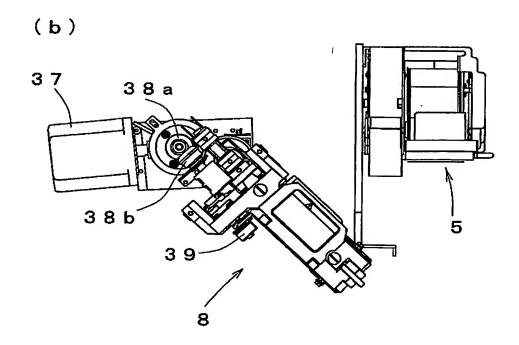



【図8】

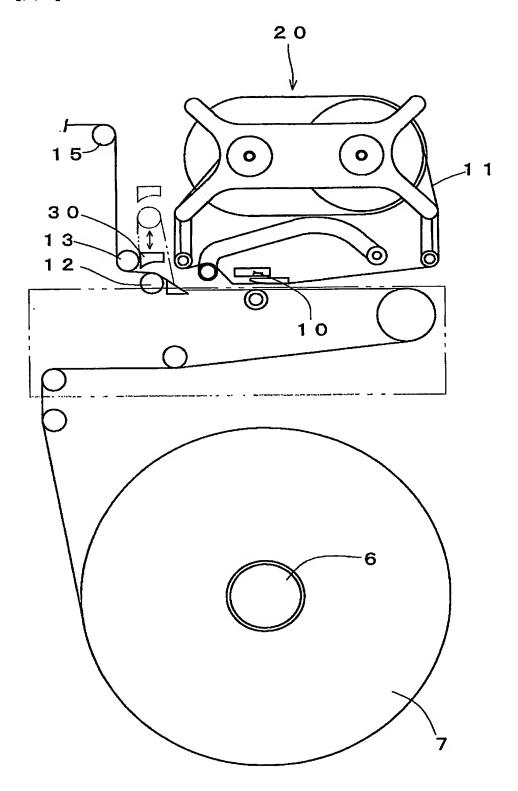



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 包装紙の所望位置に正確に印刷する。

【解決手段】 包装紙7に、印刷手段5により印刷し、薬剤供給手段2,3により薬剤を供給し、シール手段34によりシールを施すことにより、1包分ずつ包装する。前記シール手段34を、包装紙7を搬送する搬送部を備えた構成とする。前記印刷手段5から前記シール手段34に至る搬送経路の途中に、前記包装紙が接触して張力が一定値に維持されるように移動する移動手段12と、移動手段12の移動位置を検出する位置検出手段33とを設ける。そして、位置検出手段33により前記移動手段12による移動位置が所定位置となることにより、前記搬送部による包装紙7の搬送位置に基づいて、前記印刷手段5による印刷を開始させる。

【選択図】 図1



特願2003-099549

出願人履歴情報

識別番号

[592246705]

1. 変更年月日

1992年11月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府豊中市名神口3丁目3番1号

氏 名 株式会社湯山製作所